

## お詫びと訂正

映像情報メディカル2017年12月号P87に掲載の図4図説に誤りがございました。下記のとおり訂正させていただくとともに、訂正後の図4を掲載いたします。このたびは、読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

誤) (a) 40keVにおけるVR画像

(b) 55keVにおけるVR画像



正) (a) 55keVにおけるVR画像

(b) 40keVにおけるVR画像

【訂正図】映像情報メディカル2017年12月号P87図4

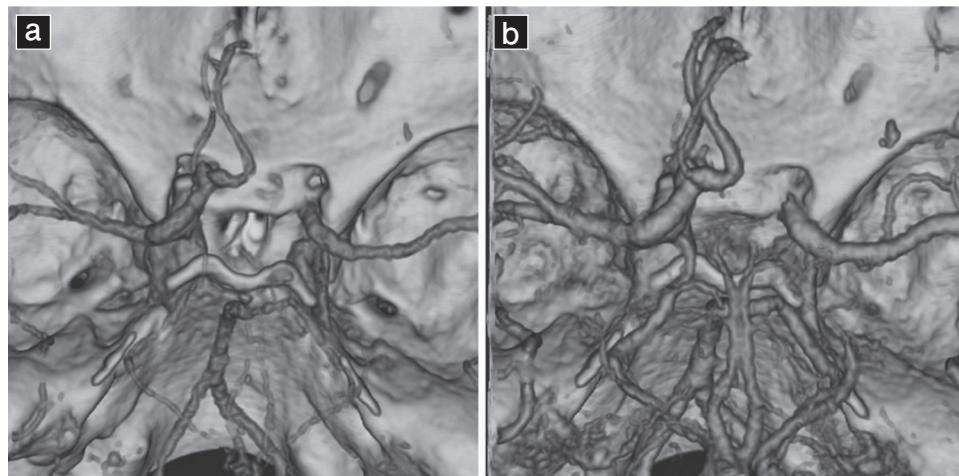


図4 デュアルエネルギーにより撮影された造影不良のVR画像(同一オパシティ設定)  
低エネルギーの使用で造影効果が改善した。

a: 55keVにおけるVR画像

b: 40keVにおけるVR画像

※掲載図の画像には訂正がないため、ここでは都合によりモノクロにて掲載しております。ご了承ください。